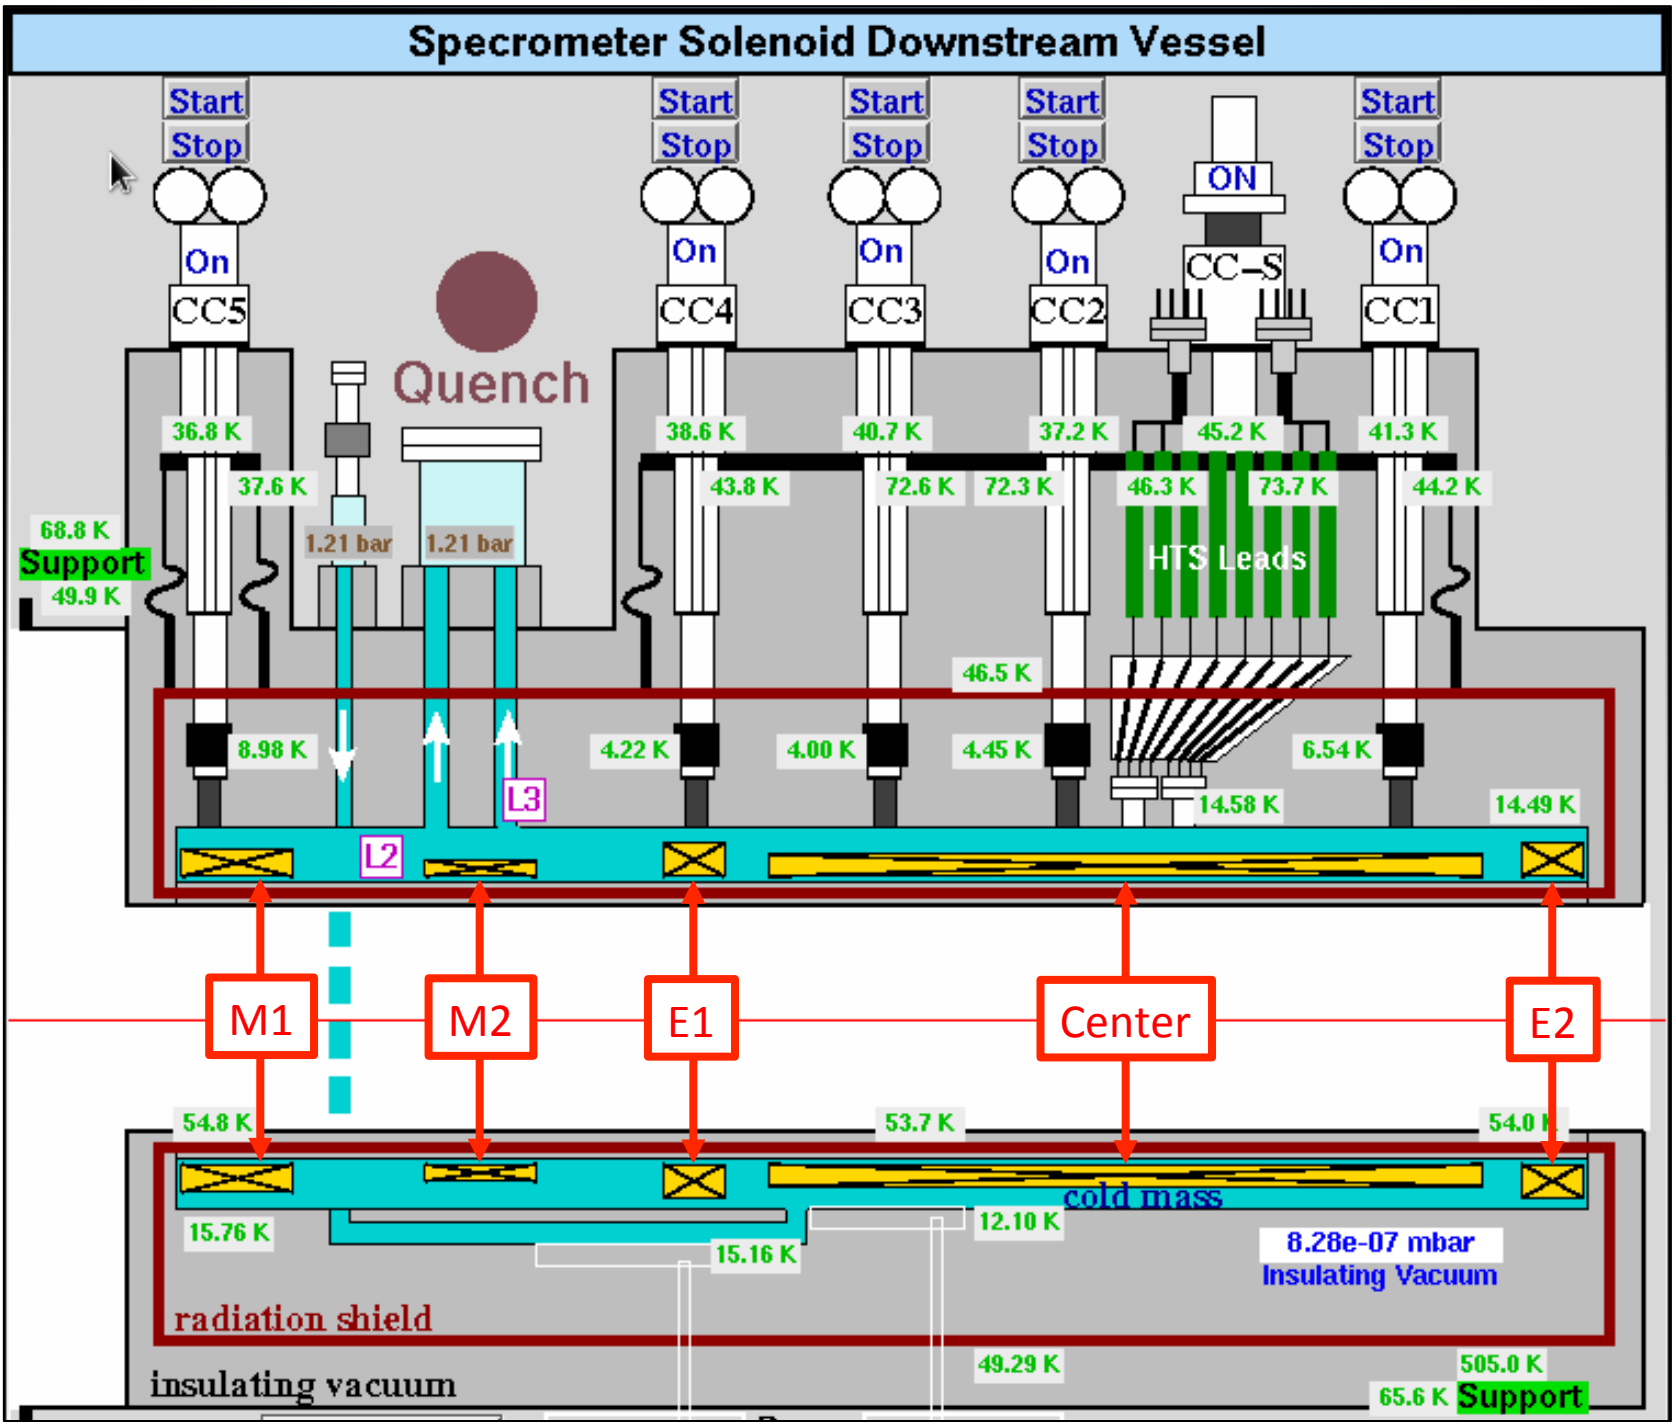
Specrometer Solenoid Downstream Vessel
Start
Stop
On
CC5
CC4
CC3
CC2
CC1
ON
CC-S
Quench
36.8 K
37.6 K
38.6 K
43.8 K
40.7 K
72.6 K
37.2 K
72.3 K
45.2 K
46.3 K
73.7 K
41.3 K
44.2 K
68.8 K
Support
49.9 K
1.21 bar
1.21 bar
HTS Leads
46.5 K
8.98 K
4.22 K
4.00 K
4.45 K
6.54 K
14.58 K
14.49 K
L3
L2
M1
M2
E1
Center
E2
54.8 K
53.7 K
54.0 K
cold mass
15.76 K
15.16 K
12.10 K
8.28e-07 mbar
Insulating Vacuum
radiation shield
insulating vacuum
49.29 K
505.0 K
65.6 K
Support